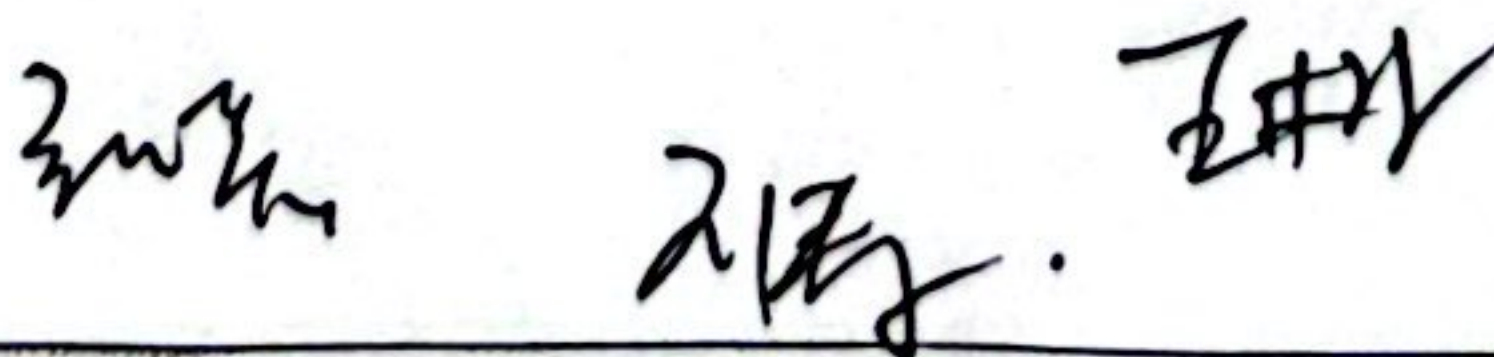


直接采购专业人员论证表

申请科室	眼科					
联系人	王涛		联系电话		15085575959	
采购项目名称	遵义市第一人民医院儿童青少年近视防控平台采购公告（设备/系统）					
拟定直接采购供应商名称	贵阳吉立安科技有限公司		供货商联系人及联系电话		程磊、15285593303	
采购品目	品名	生产企业	单价（元）	数量	金额（元）	是否需要授权
	儿童青少年近视防控平台系统	杭州轻派科技有限公司	150000	1套	150000	是
申请理由	□理由一：需采用不可替代的专利或者专有技术； ☒ 理由二：能满足需求的厂家/供货商有且仅有1家； □理由三：需向原厂商采购，否则将影响施工或者功能配套要求；					
采购人申请理由具体说明	鉴于遵义市疾控中心、遵义医科大学附属医院已采购杭州轻派科技有限公司的“儿童青少年近视防控平台系统”，且贵阳吉立安科技有限公司为该品牌授权供应商。为保障我院眼科后续开展青少年视觉筛查时，实现数据录入精准匹配、跨机构信息无缝共享，规避不同系统技术架构差异引发的数据断层问题，需接入统一平台。因此，申请以单一来源方式向贵阳吉立安科技有限公司采购该信息平台，确保筛查工作连贯及数据有效互通。					
选择该理由的原因			要求		是否满足	
	理由一需同时满足3项条件		(1)项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）			
			(2)项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性			
			(3)因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
	理由二需满足条件		本项目需求为独家产品，只有一个厂家生产，只能从特定供应商处采购。		是	
理由三需满足条件		配套试剂、耗材及配件均为专机专用，具有不可替代性。				
专家结论：	该项目需直接采购。					
科务会签字：						日期：2025年10月21日